



Leitfähigkeits-/
Reinstwassermesszellen
mit 2-Elektrodensystem

Conductivity-/
high-purity water
cells
with 2-electrode system

Cellules de mesure de
conductivité
pour eau ultra-pure
avec système à deux
électrodes

Typ 202922,
Typ 202923,
Typ 202924,
Typ 202925,
Typ 202926,

B 20.2922.0
Betriebsanleitung
Operating Instructions
Notice de mise en service

03.06/00449917

1 Hinweis

Sollten bei der Inbetriebnahme Schwierigkeiten auftreten, bitten wir Sie, keine Manipulationen am Gerät vorzunehmen. Sie gefährden dadurch Ihren Garantieanspruch! Bitte setzen Sie sich mit der nächsten Niederlassung oder mit dem Stammhaus in Verbindung.

2 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung ist für konduktive Leitfähigkeitsmesszellen der Typenblätter 20.2922, 20.2923, 20.9224, 20.2925 und 20.2926 gültig.

Konduktive Leitfähigkeitsmesszellen werden in Verbindung mit geeigneten Messumformern in der betrieblichen Analysenmesstechnik zur Bestimmung der elektrolytischen Leitfähigkeit von flüssigen Medien (bzw. des Widerstandes bei Reinstwasser) eingesetzt.

3 Messprinzip

Zwei leitfähige Elektroden definierter Fläche werden in einem bestimmten Abstand zueinander in das Messmedium eingetaucht. Durch den separaten Messumformer werden sie mit einer Wechselspannung bestimmter Messfrequenz (je nach Messbereich) versorgt. Durch die im Messmedium enthaltenen leitfähigen Anteile (Ionen, Salze) stellt sich zwischen den Elektroden ein Wechselstrom ein, über den der Messumformer die Leitfähigkeit ermittelt, anzeigt und in ein Normsignal wandelt.

4 Labor- bzw. Industriemesszellen

Leitfähigkeitsmesszellen bestehen aus einem Durchfluss-, Ein-tauch- oder Einschraubkörper aus Kunststoff oder Edelstahl und den eingebetteten Elektroden. Je nach Typ, Anwendung und Messbereich sind die beiden Elektroden aus Materialien wie Edelstahl, Titan, Platin oder Spezialgraphit gefertigt. Herstellerseitig werden die Leitfähigkeitsmesszellen mit einer festen Zellenkonstanten K [1/cm] ausgeliefert. Typische Zellenkonstanten sind z. B.. K=0,01 / 0,1 / 1,0 / 3,0 oder 10,0. Zwischenwerte sind in kunden-spezifischen Ausführungen möglich.

Der nachgeschaltete Messumformer muss auf die Zellenkonstante der Messzelle eingestellt sein. Je nach Anwendungsfall können in die Messzellen zusätzliche Temperaturfühler eingebaut sein.

5 Messbereiche

Der Messbereich konduktiver Leitfähigkeitsmesszellen ist physika-lisch auf maximal 200 mS/cm beschränkt.

Die folgende Tabelle zeigt eine grobe Einteilung der Messbereiche in Abhängigkeit der Zellenkonstante.

Zellenkonstante K [1/cm]	maximaler Messbereich
0,01	bis 5 µS/cm bzw. 20 MΩcm
0,01	bis 10 µS/cm
0,1	bis 3000 µS/cm
1,0	bis 15 mS/cm
3,0	bis 30 mS/cm
10,0	bis 200 mS/cm



Die tatsächlichen Messbereichsgrenzen variieren je nach Elektrodenmaterial, Bauform und nachgeschal-tetem Messumformer!

6 Elektrischer Anschluss

Je nach Ausführung werden die Messzellen mit fest angeschlossener Leitung oder einer lösbar Steckverbindung ausgeliefert.

Anschluss für	Gerätestecker	Festkabel	M12-Stecker
Außenelektrode		Weiß	1
Innenelektrode	2	Braun	2
Temperatur-kompensation ¹	1 3	Gelb Grün	3 4
Dreileiter-schaltung	-	-	5

¹ Option

- Die Anschlussleitung darf nicht über Reihenklemmen geführt werden, sondern nur direkt zum Messumformer. Verwenden Sie nur geschirmte Leitungen, möglichst nach Empfehlung / Beistellung des Herstellers!

Beachten Sie die Anweisungen zum elektrischen Anschluss in der Betriebsanleitung des verwendeten Messumformers!

7 Mechanischer Einbau

- Bitte beachten Sie die technischen Daten der Ihnen vorliegenden Messzelle (siehe technisches Datenblatt des Herstellers). Die Messzelle muss für die anlagenseits vorgegebenen Temperatur-, Druck- und Mediumsbedingungen (auch chemische Beständigkeit) geeignet sein!

Führen Sie keine mechanischen Veränderungen an der Messzelle durch (Kürzen, Anbohren, Verbiegen oder Verkratzen der Elektroden). Dies kann zum Verlust der ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit und der Gewährleistungsansprüche führen!

☞ Die Einbaulage ist prinzipiell beliebig. Jedoch muss sichergestellt sein, dass die Messzelle vom Messmedium ausreichend um- bzw. durchströmt wird (d.h. die leitfähigen Elektroden der Messzelle müssen stets voll umspült sein. Strömungsabrisse oder Gasblasen sind durch bauliche Maßnahmen zu vermeiden).

8 Wartung / Reinigung

Die Elektroden der konduktiven Leitfähigkeitsmesszelle stehen im direkten Kontakt mit dem Messmedium. **Eine regelmäßige Reinigung ist deshalb je nach Verschmutzungsneigung des Mediums durchzuführen!**

Zur Reinigung können alle geeigneten, haushaltsüblichen Reinigungsschemikalien verwendet werden. Scheuernde Reiniger sind nur bedingt geeignet! Die Messelektroden dürfen mechanisch nicht beschädigt werden! Hilfreich gegen verschiedene Ablagerungen ist z.B. verdünnte Salzsäure oder auch die Reinigung in Ultraschallbädern.

☞ Die Verwendung konduktiver Leitfähigkeitsmesszellen in stark anhaftenden, ölichen oder klebrigen Medien ist nicht zulässig - hier empfehlen wir den Einsatz unserer induktiven Leitfähigkeitsmessgeräte!

9 Fehlersuche

Bei der Fehlersuche müssen stets alle Komponenten der Leitfähigkeitsmesskette berücksichtigt werden!

Prüfen Sie neben der Messzelle auch den Messumformer und die verwendete Anschlussleitung.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Zu hoher oder zu niedriger Messwert	Messzelle verschmutzt	Kapitel 8 "Wartung / Reinigung", Seite 5
Kein Messwert Leitfähigkeit (z.B. Anzeige "0")	Leitungsbruch, falsche Anschlussbelegung. Messzelle in Luft (nicht umflossen).	Elektrischen Anschluss nochmals sorgfältig prüfen! Einbauort der Messzelle prüfen: Flüssiges Medium vorhanden?
Kein Messwert Temperatur (bei Messzellen mit integriertem Temperaturfühler)	Leitungsbruch, falscher elektrischer Anschluss.	Elektrischen Anschluss nochmals sorgfältig prüfen!
Anzeigewert instabil, schwankend	Störungen wegen falscher / mangelhaft geschirmter Anschlussleitung. Störungen durch Gasblasen.	Leitungsanschluss und -führung prüfen. Einbauort und Einbaulage der Messzelle prüfen, ggf. ändern.


Die Messzelle kann auch auf Kurzschlüsse bzw. interne Kontaktprobleme überprüft werden. Hierzu benötigen Sie einen Durchgangsprüfer (z.B. den Diodentester eines Multimeters).


10 Leitfähigkeitsmesszelle in Armatur einschrauben

- * Kabelverschraubung (1) lösen.
- * Anschlussleitung (3) der Leitfähigkeitsmesszelle (4) durch die Armatur (2) führen.
- * Leitfähigkeitsmesszelle (4) in die Armatur (2) schrauben.
Anzugsmoment ca. 2,5 Nm.
- * Kabelverschraubung (1) festziehen.
Anzugsmoment ca. 2 Nm.



Beim Ausbau der Leitfähigkeitsmesszelle aus der Armatur:
Zuerst die Kabelverschraubung (1) lösen!

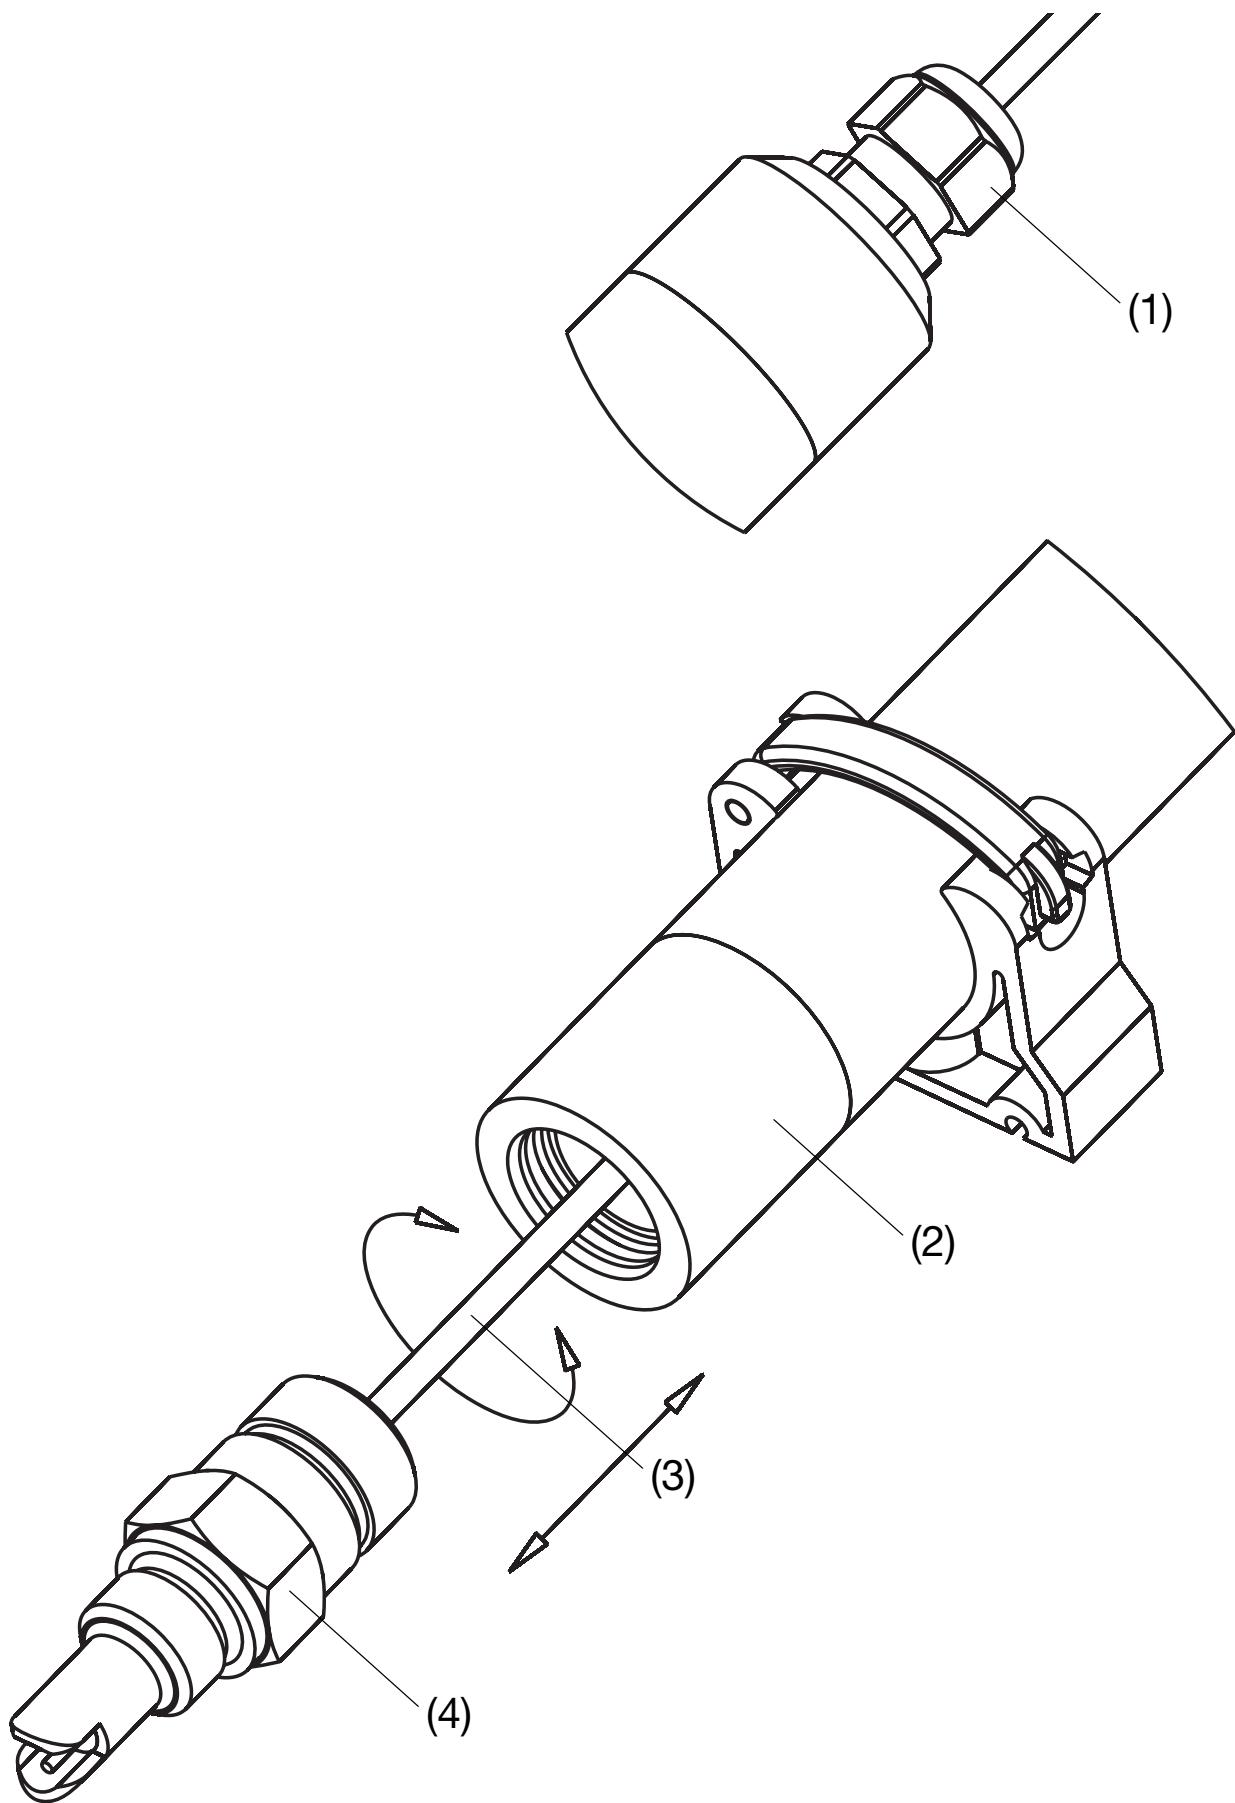

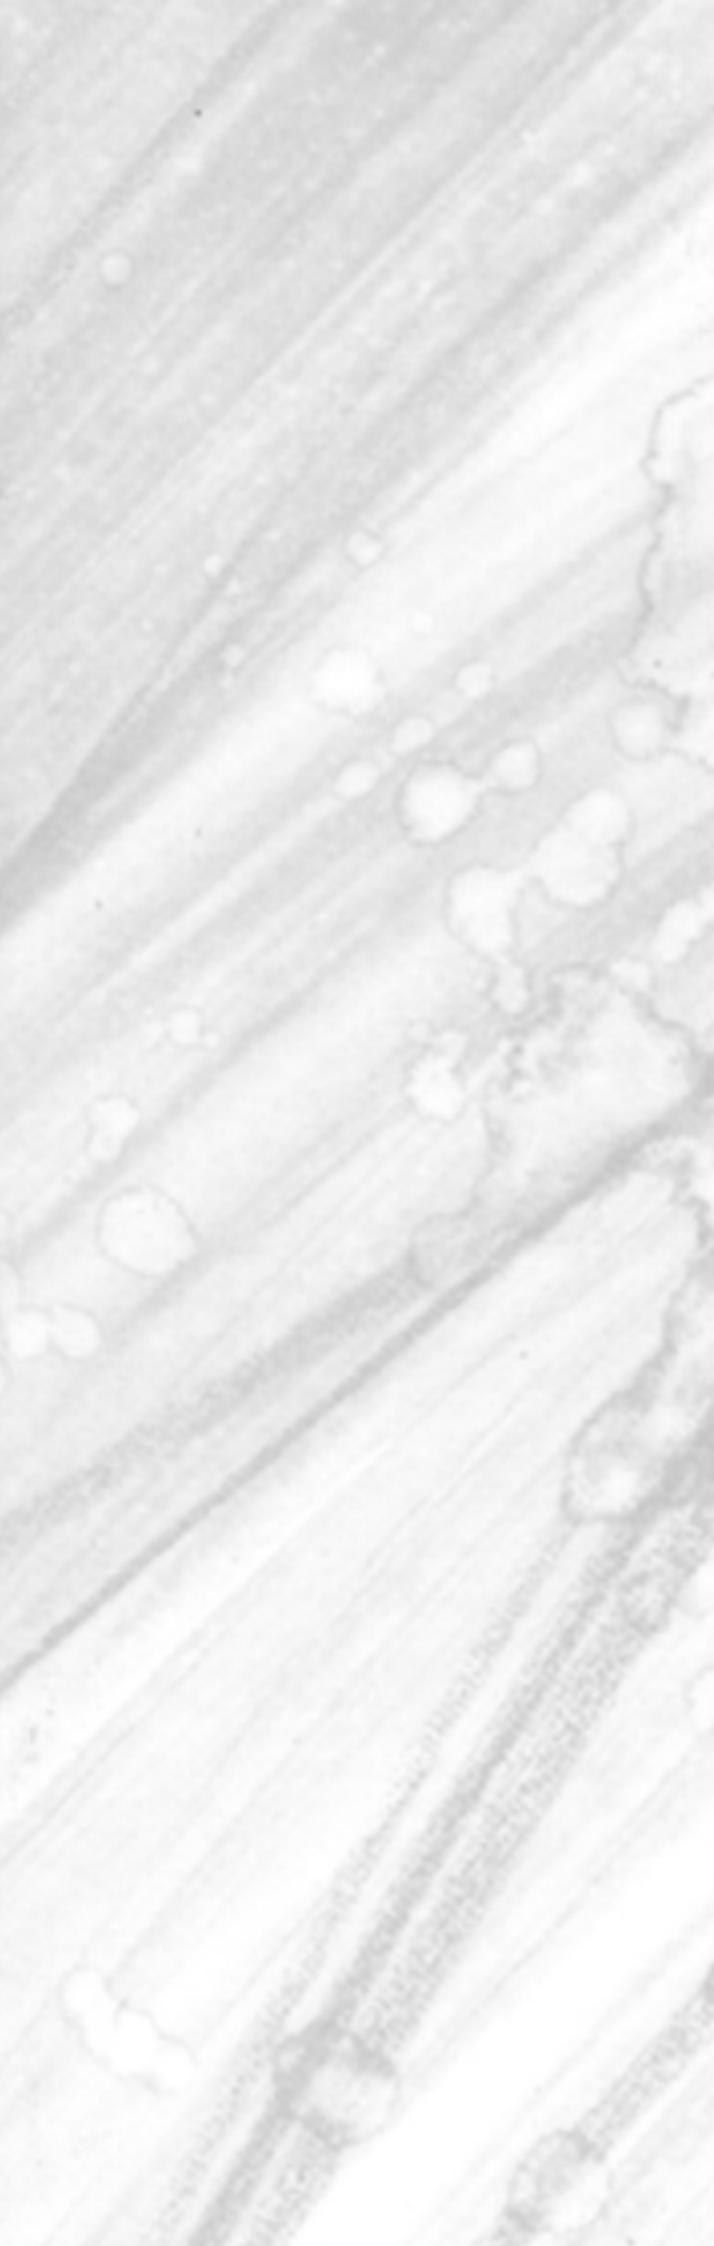

Conductivity-/ high-purity water cells

with 2-electrode system

Type 202923,

Type 202924,

Type 202925,

Type 202926,

B 20.2922.0

Operating Instructions

10.05/00449917

1 Notes

If any difficulties should still arise during start-up, please do not carry out any manipulations on the unit. You could endanger your rights under the instrument warranty! Please contact the nearest subsidiary or the head office in such a case.

2 General

These operating instructions are valid for electrolytic conductivity cells as per data sheets 20.2922, 20.2923, 20.9224, 20.2925 and 20.2926.

Electrolytic conductivity cells are used in conjunction with suitable transmitters for industrial chemical analysis, to determine the electrolytic conductivity of liquids, or the resistance in high-purity water.

3 Measurement principle

Two conductive electrodes of a defined surface are immersed in the medium at a certain distance to each other. They are supplied with an a.c. voltage of a specific frequency (depending on the measurement range) from a separate transmitter. Because of the conductive components in the medium (ions, salts), an alternating current is produced between the electrodes, which the transmitter uses to determine the conductivity, display it and convert it to a standardized signal.

4 Laboratory or industrial cells

Conductivity cells consist of a flow-through, immersion or screw-in body made from plastic or stainless steel and the electrodes embedded in it. Depending on the type, application and measurement range, the two electrodes are made from stainless steel, titanium, platinum or special graphite. The conductivity cells are supplied ex-factory with a fixed cell constant K [1/cm]. Typical cell constants are, for example, K=0.01; 0.1; 1.0; 3.0 or 10.0. Intermediate values are possible for customer-specific versions.

The subsequent transmitter must be set to the cell constant of the cell. In addition, temperature probes can be incorporated in the cell for specific applications.

5 Ranges

The range of electrolytic 2-electrode conductivity cells is physically restricted to a maximum of 200 mS/cm.

The table below shows the rough division of the ranges, related to the cell constant.

Cell constant K [1/cm]	Maximum range
0.01	up to 5 µS/cm or 20 MΩcm
0.01	up to 10 µS/cm
0.1	up to 3000 µS/cm
1.0	up to 15 mS/cm
3.0	up to 30 mS/cm
10.0	up to 200 mS/cm

 The actual range limits vary according to the electrode material, style and subsequent transmitter!

6 Electrical connection

Depending on the version, the cells are supplied with an attached cable or a detachable connector.

Connection for	Connector	Attached cable	M12 conn.
Outer electrode		white	1
Inner electrode	2	brown	2
Temperature compensation ¹	1 3	yellow green	3 4
3-wire circuit	-	-	5

¹ option

-  The connection cable must be run directly to the transmitter, and not via series terminals. Only use screened cables, preferably those recommended or supplied by the manufacturer.
Please observe the instructions for the electrical connections in the operating instructions for the transmitter used.

7 Mechanical installation

-  Please take note of the technical data for your cell (see the manufacturer's technical data sheet). The cell must be suitable for the temperature, pressure and media conditions (including the chemical resistance) prevailing at the site!
Do not make any mechanical modifications to the cell (shortening, drilling into, bending or scratching the electrodes), as this may seriously impair the proper functioning of the cell and endanger your rights under the instrument warranty!

☞ The operating position is generally unrestricted. It must, however, be ensured that the liquid can flow adequately through or around the cell (i.e. the conductive electrodes of the cell must always be completely enveloped by the liquid, and constructional measures must be taken to eliminate interruptions in the flow or gas bubbles).

8 Maintenance / cleaning

The electrodes of the electrolytic conductivity cell are in direct contact with the liquid. **It is therefore essential to clean the cell at regular intervals, depending on how prone the liquid is to contamination.**

All suitable domestic cleaning agents may be used for cleaning. Abrasive cleaning agents are generally not suitable. The electrodes must not be damaged mechanically! Deposits can be removed using diluted hydrochloric acid, or by ultrasonic cleaning, for example.

☞ The use of electrolytic conductivity cells in strongly glutinous, oily or sticky media is not permissible. In such cases, inductive conductivity measurement should be used.

9 Fault-finding

When investigating faults, all components of the conductivity electrode system must be taken into account.

Also check the transmitter and the connection cable used, in addition to the cell.

Type of fault	Possible cause	Removal
Measurement too high or too low.	Cell is dirty.	Chapter 8 "Maintenance / cleaning", page 5.
No conductivity measurement. (e.g. "0" display)	Cable break, wrong pin assignment Cell in air (not enveloped).	Check electrical connection again carefully. Check installation site of cell: is liquid present?
No temperature measurement (for cells with integral temperature probe).	Cable break, wrong electrical connection.	Check electrical connection again carefully.
Displayed value is not stable, unsteady.	Errors due to - wrong/ inadequately screened connecting cable - gas bubbles	Check cable connection and layout. Check installation site and position of cell, alter it, if necessary.


The cell can also be checked for short-circuits or internal contact problems. This can be done using a continuity tester (e.g. the diode tester of a multimeter).


10 Screwing the type BlackLine Lf-EC conductivity cell into the fitting

- * Undo cable gland (1).
- * Pass connection cable (3) of the conductivity cell (4) through the fitting (2).
- * Screw conductivity cell (4) into the fitting (2).
tightening torque: approx 2.5 Nm.
- * Tighten cable gland (1),
tightening torque: approx 2 Nm.



**When removing the conductivity cell from the fitting:
Undo the cable gland (1) first !**

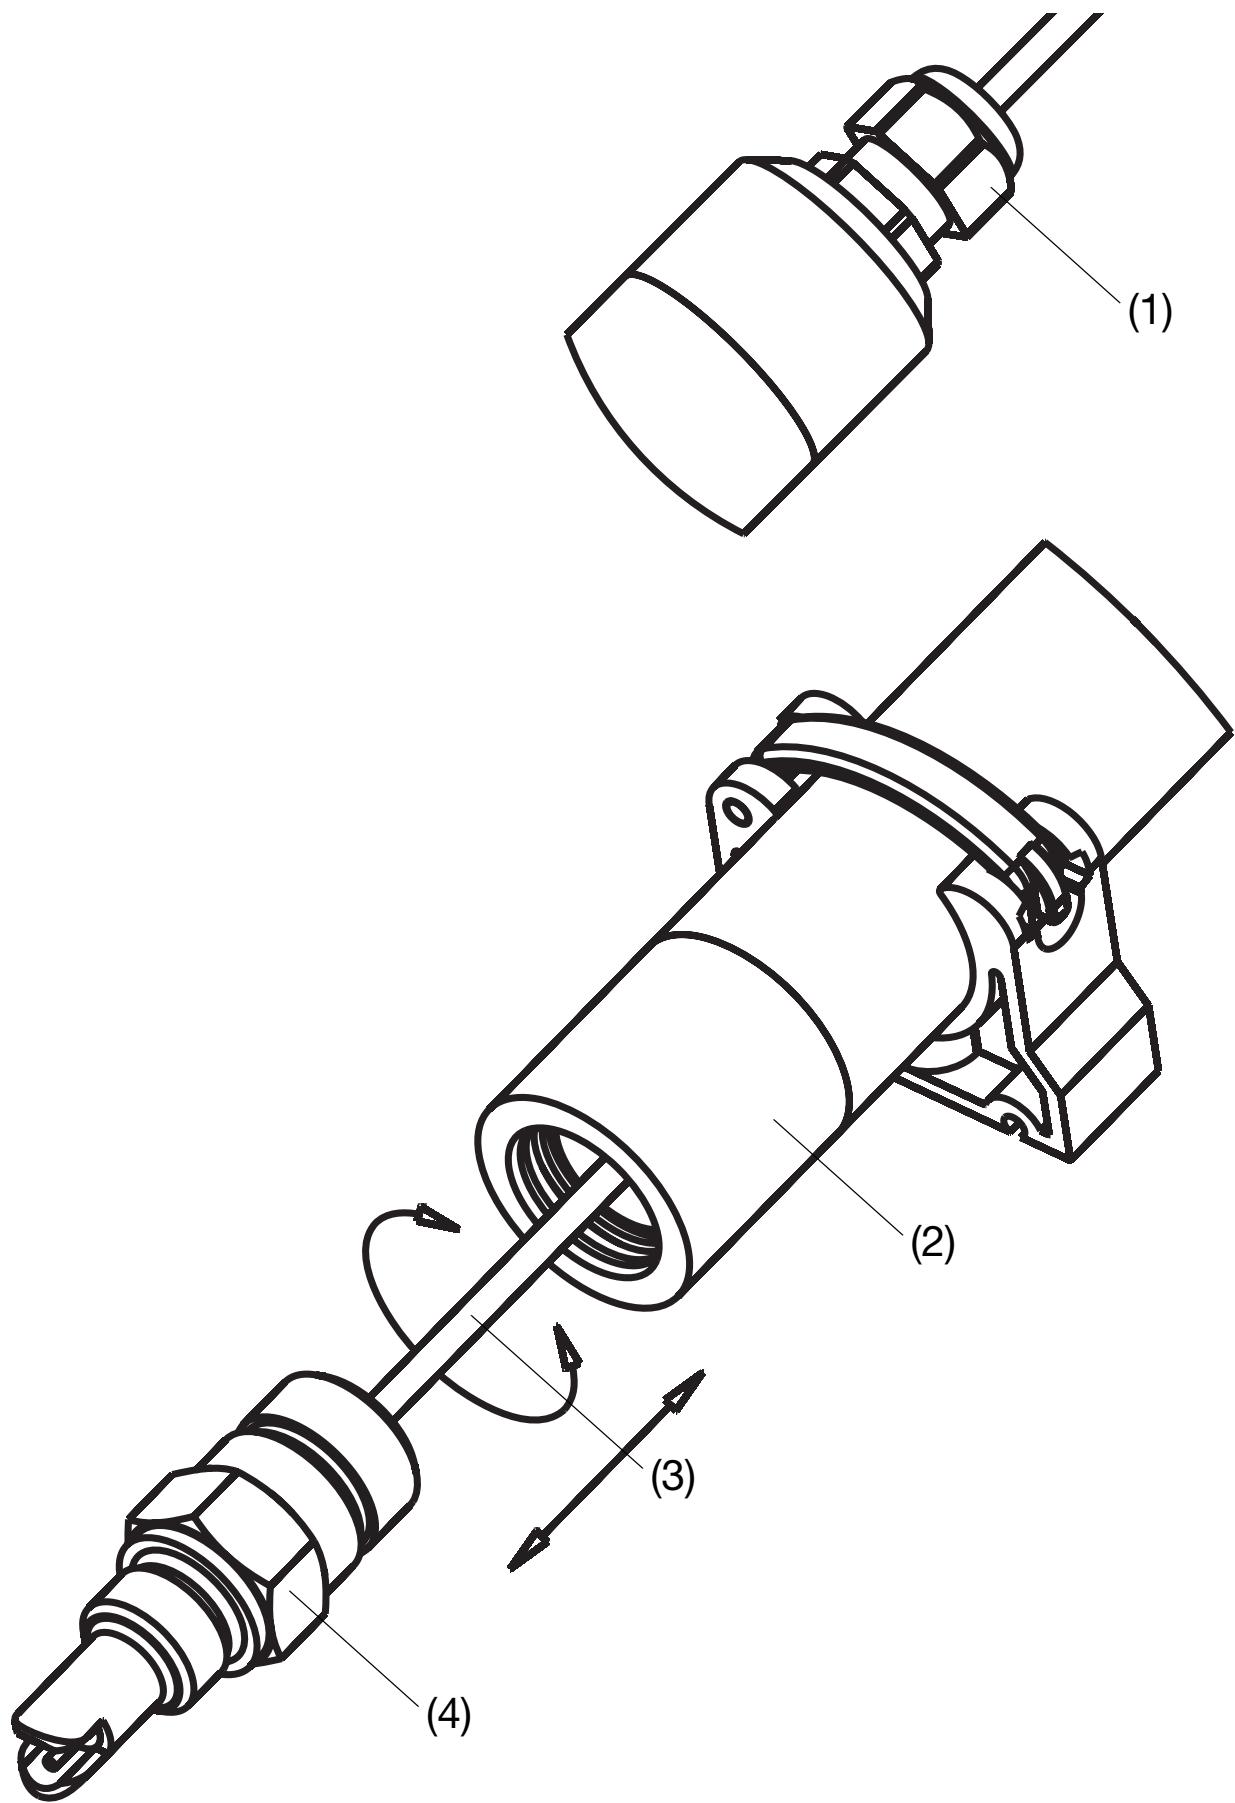

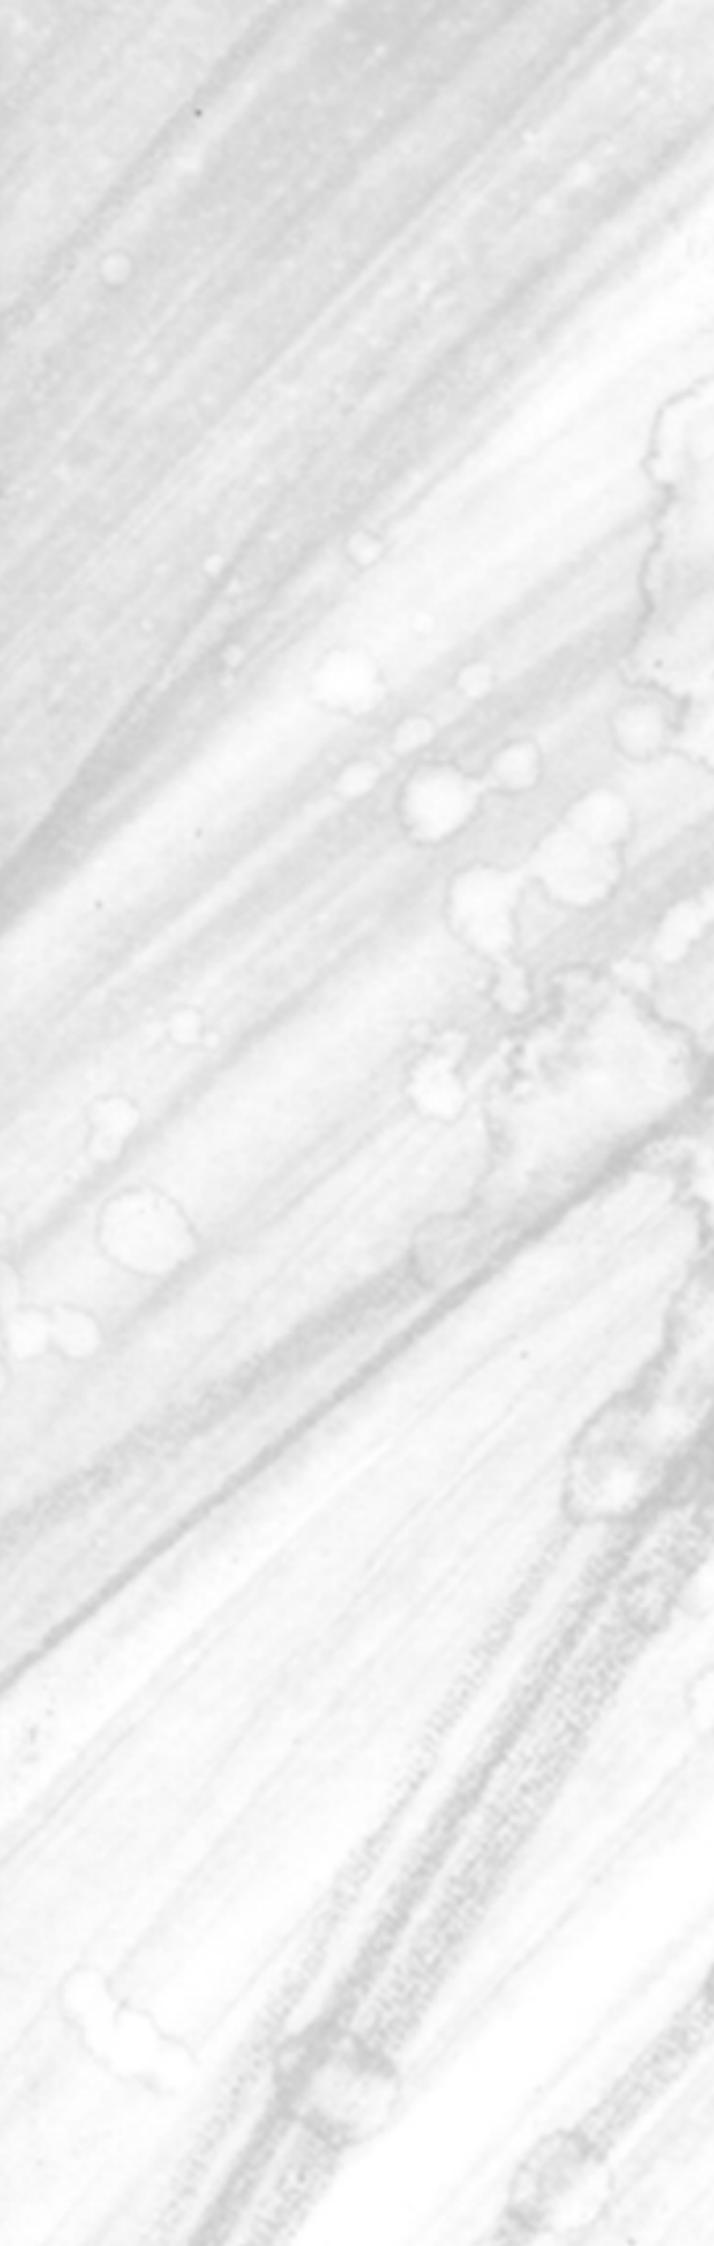

**Cellules de mesure de
conductivité
pour eau ultra-pure
avec système à deux
électrodes**
Type 202923,
Type 202924,
Type 202925,
Type 202926,

B 20.2922.0
Notice de mise en service
10.05/00449917

1 Nota

Tous les réglages nécessaires sont détaillés dans cette notice de mise en service. Toutefois si vous rencontrez des difficultés lors de la mise en service, n'effectuez aucune intervention non autorisée sur l'appareil. Vous pourriez compromettre votre droit à la garantie. Veuillez prendre contact avec nos services.

2 Généralités

Cette notice est valable pour les cellules de mesure de conductivité par conduction des fiches techniques 20.2922, 20.2923, 20.9224, 20.2925 et 20.2926.

Les cellules de mesure de conductivité raccordées à des convertisseurs de mesure sont utilisées lors d'analyses physico-chimiques industrielles pour déterminer la conductivité de liquides (ou la résistance de l'eau ultra-pure).

3 Principe de mesure

Deux électrodes de mesure conductrices, de surface définie sont immergées dans le milieu de mesure avec un écart(ement) défini. Le convertisseur de mesure les alimente avec une tension alternative d'une réquence de mesure définie (suivant l'étendue de mesure). Un courant alternatif apparaît entre les 2 électrodes dans le milieu de mesure (ions, sels) et permet au convertisseur de mesure de déterminer la conductivité , de l'afficher et de la convertir en un signal normalisé.

4 Cellules de mesure pour laboratoire et industrie

Les cellules de mesure de conductivité sont composées d'un corps (chambre de passage), tube d'immersion ou corps à visser en matière synthétique ou en acier inoxydable et d'électrodes encastées dans ce corps. Suivant le type, l'application et l'étendue de mesure, les 2 électrodes sont fabriquées en acier inoxydable, titane, platine ou graphite spécial. Du côté du fabricant, les cellules de mesure de conductivité sont livrées avec une constante de cellule fixe K [1/cm]. Les constantes de cellules typiques sont par ex. K=0,01 / 0,1 / 1,0 / 3,0 ou 10,0. Des valeurs intermédiaires sont possibles.

Le convertisseur de mesure raccordé doit être ajusté aux constantes de cellule de la cellule de mesure. Suivant le cas d'application, un capteur de température peut être intégré à la cellule de mesure.

5 Etendues de mesure

L'étendue de mesure de cellules de mesure de conductivité à 2 électrodes est physiquement limitée à 200mS/cm max.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une classification approximative des étendues de mesure par rapport aux constantes de cellule.

Constante de la cellule K [1/cm]	Etendue de mesure max.
0,01	jusqu'à 5 µS/cm ou 20 MΩcm
0,01	jusqu'à 10 µS/cm
0,1	jusqu'à 3000 µS/cm
1,0	jusqu'à 15 mS/cm
3,0	jusqu'à 30 mS/cm
10,0	jusqu'à 200 mS/cm



Les limites d'étendue de mesure effectives varient suivant le matériel des électrodes, leur forme ainsi que du convertisseur de mesure raccordé !

6 Raccordement électrique

Le raccordement électrique des cellules s'effectue soit par câble fixe soit par connecteur amovible.

Raccordement pour	Connecteur	Câble fixe	Connecteur M12
Electrode externe		blanc	1
Electrode interne	2	brun	2
Compensation de température ¹	1 3	jaune vert	3 4
Technique 3 fils	-	-	5

¹ Option

 Le raccordement ne doit pas s'effectuer par les bornes de raccordement, mais directement au niveau du convertisseur de mesure. N'utilisez que des câbles blindés, si possible sur recommandation/mise à disposition du fabricant !

Veuillez tenir compte des instructions, concernant le raccordement électrique, qui se trouvent dans la notice de mise en service du convertisseur de mesure !

7 Montage mécanique

👉 Veuillez tenir compte des caractéristiques techniques des cellules de mesure (voir fiche technique). La cellule de mesure doit être adaptée à la température, à la pression et aux conditions du milieu (également résistance chimique) !

N'effectuez aucune modification sur la cellule (raccourcir, percer, plier ou rayer les électrodes). Ceci peut endommager le bon fonctionnement des cellules ou compromettre votre droit en garantie !

👉 La position d'utilisation est au choix. Il faut cependant s'assurer, que la cellule (de mesure) baigne suffisamment dans le milieu de mesure (c.-à- d. que des détachements de courant ou des bulles de gaz dus à des mesures de construction doivent être évités).

8 Entretien/Nettoyage

Les électrodes des cellules de mesure de conductivité par conduction sont directement en contact avec le milieu de mesure. **C'est pourquoi un nettoyage régulier suivant le degré de souillure (salissure) du milieu est recommandé !**

Vous pouvez utiliser tous les détergents utilisés pour les travaux domestiques. Les produits de nettoyage abrasifs ne sont adaptés que sous conditions ! Les électrodes de mesure ne doivent pas être endommagées mécaniquement ! Vous pouvez utiliser contre différents dépôts de l'acide chlorhydrique diluée ou effectuer un nettoyage dans des bains à ultra-sons.

👉 Vous ne pouvez utiliser les cellules de mesure de conductivité dans des milieux fortement adhérents, huileux ou collants – dans ce type de milieu , il est préférable d'utiliser des systèmes de mesure de conductivité par induction !

9 Recherche d'erreur

Lorsque l'on recherche une erreur, il faut tenir compte de tous les composants de la chaîne d'arpentage de conductivité !

Veuillez tester en plus des cellules de mesure, le convertisseur de mesure ainsi que le câble de raccordement utilisé.

Erreur	Cause possible	Aide
Valeur de mesure trop grande ou trop petite	Cellule de mesure sale	chapitre8 "Entretien/Nettoyage", page 5
Pas de valeur de conductivité ("0" s'affiche par ex.)	Rupture de ligne, mauvaise position des contacts. Cellule de mesure dans l'air (non immergée).	Veuillez revérifier attentivement le raccordement électrique! Vérifier le lieu de montage de la cellule: présence d'un milieu liquide ?
Pas de valeur de température (pour cellules de mesure avec sonde intégrée)	Rupture de câble, mauvais raccordement électrique.	Veuillez revérifier attentivement le raccordement électrique!
Valeur affichée instable, variable	Perturbations dues à un mauvais câble de raccordement / blindage insuffisant.	Vérifier le raccordement du câble et le câble. Vérifier le lieu de montage et la position d'utilisation de la cellule de mesure, modicier si nécessaire.

La cellule de mesure peut être testée par rapport aux courts-circuits ou à des problèmes de contacts internes. Pour cela un appareil de contrôle de continuité (par ex. le testeur diode d'un appareil multimètre).

10 Visser la cellule de mesure de conductivité dans l'armature

- * Desserrer l'entrée de câble par presse-étoupe (1).
- * Passer le câble de raccordement (3) de la cellule de mesure (4) à travers l'armature (2).
- * Visser la cellule de mesure (4) dans l'armature (2).
Temporisation au démarrage env. 2,5 Nm.
- * Resserrer l'entrée de câble par presse-étoupe (1).
Temporisation au démarrage env. 2 Nm.

 **Pour sortie la cellule de mesure de l'armature :**
il faut d'abord desserrer l'entrée de câble par presse-étoupe (1) !

